



Förderndes Mitglied der  
Deutschen Hochdruckliga

Förderndes Mitglied der  
Deutschen Diabetes Stiftung

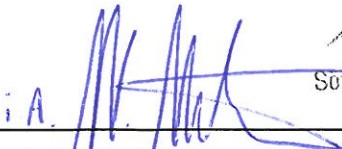
## RiLiBÄK-Konformität

Hiermit bestätigen wir, dass die Blutzuckermessgeräte:

- GL32 mg/dL und GL32 mmol/L
- GL34 mg/dL und GL34 mmol/L
- GL40 mg/dL und GL40 mmol/L
- GL44 mg/dL und GL44 mmol/L
- GL50 mg/dL und GL50 mmol/L

von Beurer den aktuellen „Richtlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen“ (RiLiBÄK) entsprechen.

Die Beurer Blutzuckermessgeräte sind zur Eigenanwendung als auch für den Gebrauch durch Fachpersonal nach der Europäischen Richtlinie über In-vitro-Diagnostika (98/79/EC) zugelassen.

  
Beurer GmbH  
Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm

Ulm, 2011-09-08

Beurer GmbH

Dipl. Ing. (FH) Werner Meternek

Leiter Technologie & Entwicklung